

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

联系人：陈老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2026.8.21

chenwenjia@ustc.edu.cn

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682


采购名称：入射光强检测室

预算：200000 元

技术要求：

入射光强监测室 2 套，主要技术参数如下：

1. 按照设计图纸加工，材质 316 不锈钢，包含观察窗不少于 3 个，CF16 BNC feedthrough 一个，金网支架一个（不含金网，有效面积 $1\text{cm} \times 1\text{cm}$ ，含两层 μ -金属屏蔽罩和一层不锈钢罩），CF35 直线导入器一个（行程 $\geq 6\text{cm}$ ），旋转导入器一个，金属角阀一个（CF35），国产微型离子泵一套（抽速 10L/s ，安装法兰 CF35）。
2. 整体真空漏率 $< 1.33 \times 10^{-8} \text{ Pa.l/s}$
3. 采用真空兼容且耐烘烤屏蔽信号线，整体烘烤不低于 120°C 。

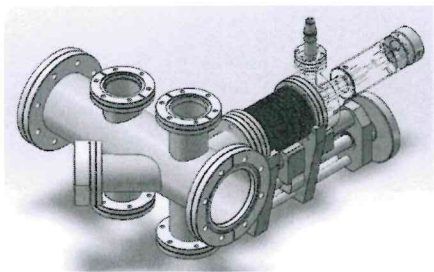

交货期：合同签订后 12-14 周内

交付进度：一次性交付

付款方式：合同签订后预付合同总额的 40%，到货验收合格支付合同尾款

验收指标及验收要求：整体真空漏率 $< 1.33 \times 10^{-8} \text{ Pa.l/s}$

保修及售后服务：一年质保。

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

标准件需要注明品牌和型号，非标加工件需要注明生产厂商。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份（授权时限至少覆盖正式签署本项目合同之日），技术指标供及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

